

「シールタッチ[®]カニューラGA」 仕様変更のお知らせ

謹啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。

さて、この度「シールタッチカニューラGA」（医療機器認証番号：228AABZX00081000）の仕様を下記の通り変更いたしますので、ご案内申し上げます。今後とも引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。


謹白

変更理由

コンテナから取り出す際の抵抗を抑えるため。

変更内容

コンテナとの接触位置をルアーコネクタ部からカニューラキャップへ変更いたしました。

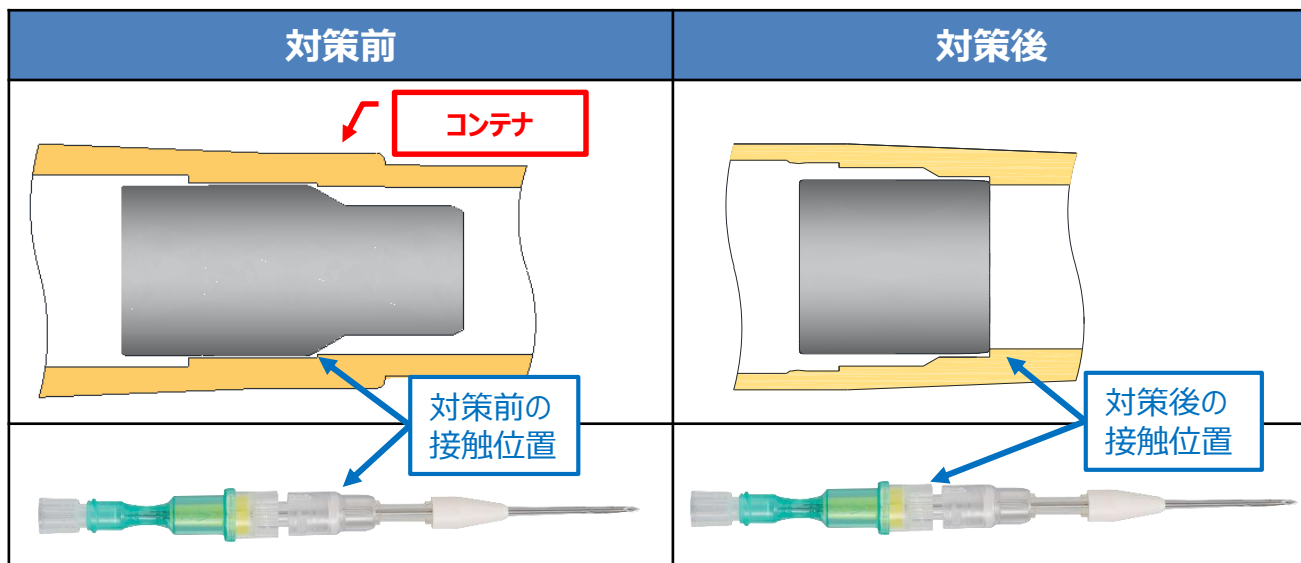

切替品番、ロット一覧

商品コード	商品名	変更ロット
69026	NEL*15AC4X25RU GA	未定
69027	NEL*16AC4X25RU GA	24E10U
69028	NEL*17AC4X25RU GA	24E11U
69016	NEL*15AC4X32RU GA	24C01U
69017	NEL*16AC4X32RU GA	24C15U
69018	NEL*17AC4X32RU GA	24C13U
69006	NEL*15AC4X38RU GA	未定
69007	NEL*15AC4X38RU GA	未定
69008	NEL*17AC4X38RU GA	未定