

「UKカフ付カテーテル」 仕様変更のお知らせ

謹啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度「UKカフ付カテーテル」(医療機器承認番号：22400BZX00343000)の
カニューラ外套型穿刺針の仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

何卒、ご高承のうえ、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。


謹白

変更点

対象製品：UKカフ付カテーテル 全品番

製品内製化のため、カニューラ外套型穿刺針を自社製品に変更いたします。
本変更により、外套根本の形状がファンネル形状からルーアーロックタイプのストレート形状に変更になります。

【比較写真】17Gカニューラ（外針ハブカラー：パープル）

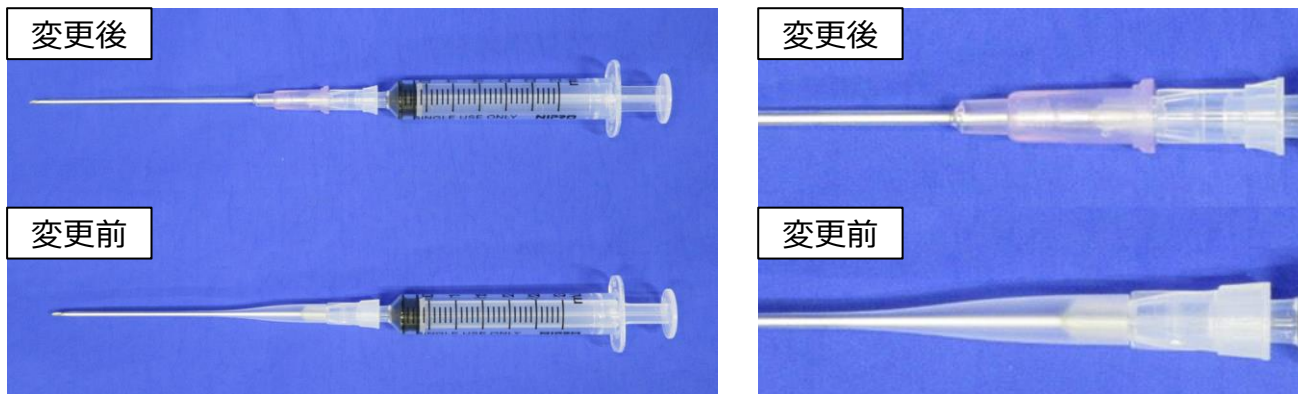

変更品は、製品ラベル、内箱ラベルに「」のマーク付いております。

【例】左：製品ラベル、右：内箱ラベル（40-693：UKカフツキ UB-1225-WPJS）

25
cm (7'1/4")

シンメトリタイプ



生物 ◆ 高度管理医療機器
UKカフ付カテーテル
ダブルルーメン
(ウロキナーゼ使用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル)

医療機器承認番号 22400BZX00343000
商品コード 40-693
商品名 UKカフツキ UB-1225-WPJS

シンメトリタイプ

カテーテルサイズ
12.5 Fr (4.2mm) × 25 cm (7'1/4")

特定保険医療材料請求分類 ブラッドアクセスカテロカフ
製造管理番号 36000000
使用期限 2028年02月29日

セット内容
1.カフ付ウロキナーゼ固定化カテーテル
(X線不透過材料)
2.ウロキナーゼ
3.トンネル
4.ピルアウエイントロデュサー(シース)
5.ピルアウエイントロデュサー(ダイレクター)
6.金医穿刺針(18G)
7.アイワイヤ(0.038" (0.97mm) × 60cm、
先端形状J&Sストレート型)
8.カニューラ外套型穿刺針
(17G、3mLシリンジ付)
9.メス
10.穴あきドレープ

=エチレンオキサイドガス滅菌済=



(01) 0466/45846655 (17) 28229 (10) 36000000

シンメトリタイプ



1セット入

生物 ◆ 高度管理医療機器
UKカフ付カテーテル
ダブルルーメン
(ウロキナーゼ使用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル)

医療機器承認番号 22400BZX00343000
商品コード 40-693
商品名 UKカフツキ UB-1225-WPJS

シンメトリタイプ

カテーテルサイズ
12.5 Fr (4.2mm) × 25 cm (7'1/4")

特定保険医療材料請求分類 ブラッドアクセスカテロカフ
製造管理番号 36000000
使用期限 2028年02月29日

=エチレンオキサイドガス滅菌済=



(01) 0466/45846655 (17) 28229 (10) 36000000

再使用禁止

- 電子原文の内容を確認の上、使用してください。
- 使用は1回限りとし、使用後は直ちに廃棄してください。
- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。

=エチレンオキサイドガス滅菌済=



1セット入

製造販売 **ニプロ株式会社**
大阪府堺市千原区新町3番28号

変更ロットと
変更予想時期

商品コード	製品名	ロット	変更予想時期
40680	UKカツキ UB-1218-WPJS	36504011	2025年8月上旬
40681	UKカツキ UB-1221-WPJS	36504012	2025年7月中旬
40691	UKカツキ UB-1221-WPS	未定	2025年9月下旬
40692	UKカツキ UB-1223-WPJS	36504014	2025年6月中旬
40693	UKカツキ UB-1225-WPJS	36505011	2025年9月下旬
40694	UKカツキ UB-1228-WPJS	未定	2025年月10月中旬
40695	UKカツキ UB-1228-WPS	35504011	2025年9月中旬
40696	UKカツキ UB-1233-WPS	未定	2026年1月下旬
40697	UKカツキ UB-1216-WPJS	未定	2025年11月上旬
40698	UKカツキ UB-1218-WPJS3	未定	2025年10月頃
40699	UKカツキ UB-1221-WPJS3	36504013	2025年6月下旬

※変更時期が先の製品につきましては時期がきましたら改めてご案内いたします。