

「ニプロ消化管用バルーンカテーテル G-dive®」仕様変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「ニプロ消化管用バルーンカテーテル G-dive」について仕様変更を行うことになりましたのでご案内申し上げます。


謹白

変更内容および変更理由


【バルーンカテーテルのシャフトを不透明色に変更】

- ・シャフトとバルーンの接合部を視認しやすくするため、従来の半透明素材から不透明色のシャフトに変更します。（材質の変更はございません。）

変更前

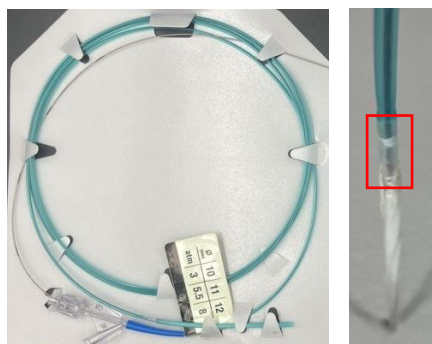

変更後

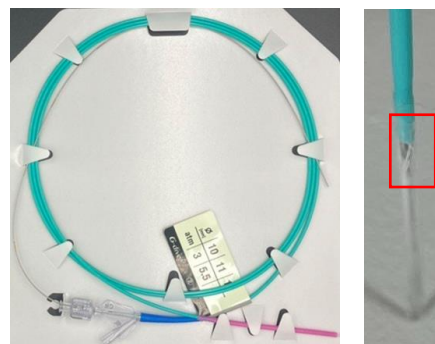


□：シャフトとバルーンの接合部

【コストシールの追加】

- ・製品の内箱に「内視鏡使用報告書」貼付用の識別シール(コストシール)を2枚同梱します

変更前

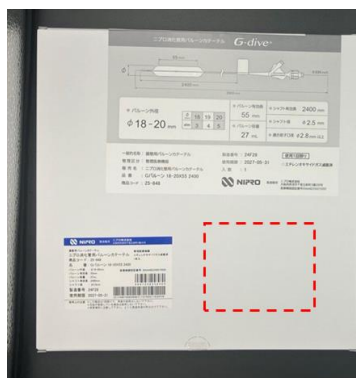

変更後



対象品番・変更時期

1. 製品名 : ニプロ消化管用バルーンカテーテル

2. 医療機器認証番号 : 304AABZX00070000

医療機器クラス分類 : クラスⅡ (管理医療機器)

商品コード	JANコード	品番・規格	変更ロット	変更品出荷時期
25-837	4987458258374	Gバルーン 6-8X55 1800	25I16	2026年4月
25-838	4987458258381	Gバルーン 8-10X55 1800	25I17	2025年12月
25-839	4987458258398	Gバルーン 10-12X55 1800	26AXX	未定
25-840	4987458258404	Gバルーン 12-15X55 1800	未定	未定
25-841	4987458258411	Gバルーン 15-18X55 1800	未定	未定
25-842	4987458258428	Gバルーン 18-20X55 1800	未定	未定
25-843	4987458258435	Gバルーン 6-8X55 2400	25LXX	未定
25-844	4987458258442	Gバルーン 8-10X55 2400	26BXX	未定
25-845	4987458258459	Gバルーン 10-12X55 2400	25JXX	未定
25-846	4987458258466	Gバルーン 12-15X55 2400	25JXX	未定
25-847	4987458258473	Gバルーン 15-18X55 2400	未定	未定
25-848	4987458258480	Gバルーン 18-20X55 2400	未定	未定

26AXXの「XX」は未定です。

以上